

Lovibond Scuba 3s – Smart Pooltester

Uživatelský návod – česká verze



Tester Scuba 3s měří následující parametry:

Volný a celkový chlór, vázaný chlór, pH, kyselinu kyanurovou (stabilizátor), celkovou alkalitu, tvrdost vápníku, aktivní kyslík, měď a forfáty.

Rozsah měření:


Označení:	mg/l	hodnoty OK	tablety	Označení
Cl F	0.1 - 6.0	3 - 4	DPD No.1	525620 / 525621
Cl T	0.1 - 6.0	3 - 4.5	DPD No.1 + DPD No.3 Evo	525620 / 525621
Cl Comb.	0.1 - 6	0 - 0.5	DPD No.1 + DPD No.3 Evo	525620 / 525621
Br	0.2 - 13.5	1.5 - 8.5	DPD No.1	525620 / 525621
pH	6.5 - 8.4	6.8 - 7.6	Phenol Red Photometer	525620 / 525621
CyA	20 - 120	30 - 50	CyA-Test	525621
TA	5 - 300	50 - 150	Alka-M Photometer	525621
CaH	50 - 500	175 - 400	Calcio-H No.1 + Calcio-H No.2	525652
O2 Act.	0.2 - 10	3 - 8	DPD No.4 Evo	525651
Cu	0.1 - 5	0.05 - 0.3	Copper No.1	525653
PO4	0.06 - 3	0.06 - 0.25	Phosphate No. 1 LR + Phosphate No.2 LR	

Začínáme:

Vložení baterií – Otevřete kryt přihrádky na baterie. Vložte dvě baterie typu AA, dbejte na správnou polaritu. Kryt pevně uzavřete.




Nastavení data a času – Pomocí tlačítek + / - zvolte hodnoty. Potvrďte nastavení.

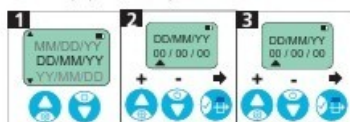

Princip testu:

Měření probíhá pomocí barevné reakce tablety s vodním vzorkem. Přístroj porovnává barvu před a po rozpuštění tablety a určí koncentraci látky. Používejte výhradně originální tablety Lovibond®.


Postup: 1. Odebírejte vzorek vody přímo z bazénu. 2. Vložte testovací tabletu do komory se vzorkem. 3. Přístroj změří barvu a zobrazí výsledek.

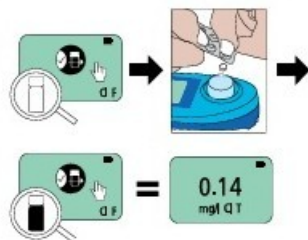


Testování:

1. Naplňte testovací komoru vzorkem vody. 2. Přidejte příslušnou testovací tabletu podle parametru, který chcete měřit. 3. Uzavřete komoru a promíchejte pomocí míchací tyčinky. 4. Spusťte měření a vyčkejte na zobrazení výsledku.

Výsledky testů: Na displeji se zobrazí koncentrace měřeného parametru v mg/l. Pokud je hodnota v doporučeném rozmezí, voda je v pořádku. Pokud je mimo rozmezí, upravte dávkování chemie dle doporučení výrobce.

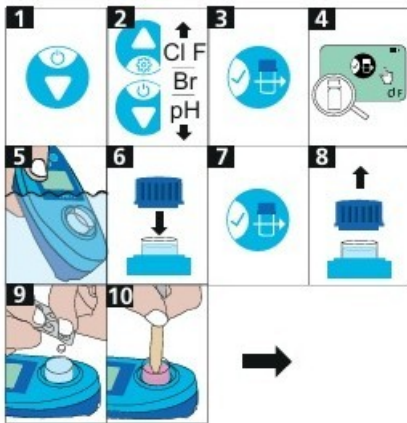


Cl F, Br, TA, CyA, pH


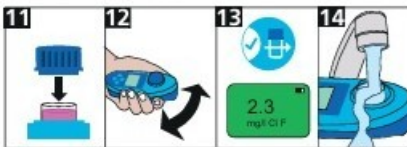


8

O2 Act., Cu

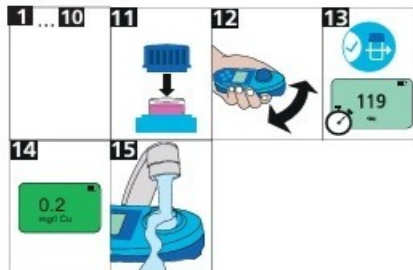


CaH, Cl T, PO4

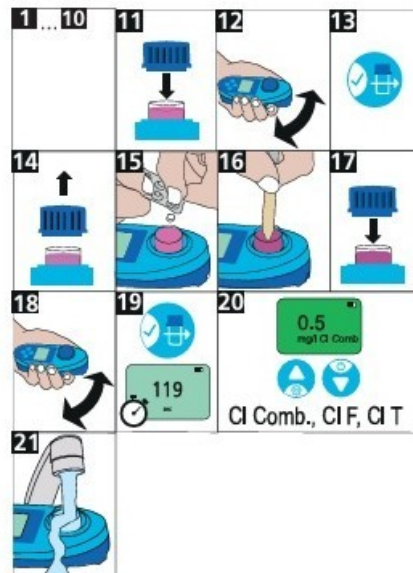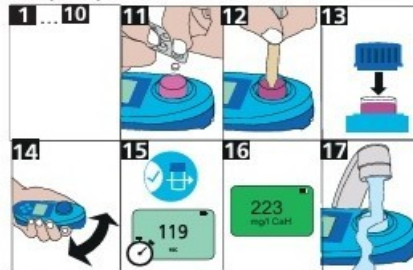


Nastavení:

Zobrazení a přenos výsledků:



(přes NFC a aplikace Lovibond® PoolAssistant). Stáhněte si aplikaci do telefonu. Poté přiložte telefon poblíž testru a potvrďte na display pomocí šipek přenos dat.

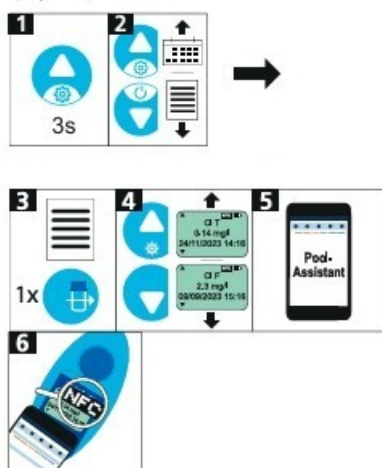

Mazání uložených dat:

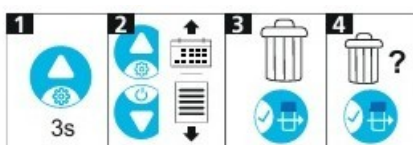

Nastavení data a času:

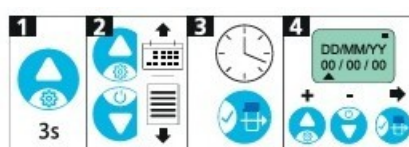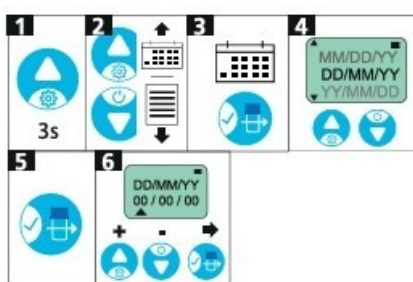

Nastavení podsvícení displeje:



Důležité bezpečnostní pokyny:

Nepoužívejte dobíjecí AA baterie. Přístroj není hračka pro děti. Tablety uchovávejte mimo dosah dětí. Tablety nejezte ani nepolykejte. Používejte pouze originální tablety Lovibond®.- Testovací komoru čistěte pouze měkkým hadříkem a vodou.

Chybová hlášení:

E1: Vyčistěte testovací komoru.

E1, E2, E3, E4: Kontaktujte svého dodavatele.

Technické údaje:

Optika: Spektrometrický senzor, více vlnových délek

Displej: LCD s podsvícením

Rozhraní: NFC, podpora aplikace Lovibond® PoolAssistant

Paměť: 100 záznamů

Napájení: 2× AA baterie (3 V DC / 55 mA)

Životnost baterií: až 5000 měření

Automatické vypnutí: po 5 minutách

Krytí: IPX7 dle DIN EN 60529

Provozní teplota: 10–50 °C

Vlhkost: 30–95 %

Maximální nadmořská výška: 3500 m n. m.